


TACONEMOMETRO OPTOELETTRONICO AD USCITA NORMALIZZATA CAMPO 0..50m/s
 OPTOELECTRONIC TACONEMOMETER WITH NORMALIZED OUTPUT RANGE 0..50m/s

- Code DNA501 : SENZA RISCALDAMENTO WITHOUT HEATER USCITA/OUTPUT 4..20mA ALIM/POWER SUPPLY 24Vdc
- Code DNA505 : SENZA RISCALDAMENTO WITHOUT HEATER USCITA/OUTPUT 0..20mA ALIM/POWER SUPPLY 24Vdc
- Code DNA507 : SENZA RISCALDAMENTO WITHOUT HEATER USCITA/OUTPUT 0..5Vdc ALIM/POWER SUPPLY 12Vdc
- Code DNA509 : SENZA RISCALDAMENTO WITHOUT HEATER USCITA/OUTPUT 4..20mA ALIM/POWER SUPPLY 12Vdc
- Code DNA502 : CON RISCALDAMENTO WITH HEATER USCITA/OUTPUT 4..20mA ALIM/POWER SUPPLY 24Vdc
- Code DNA506 : CON RISCALDAMENTO WITH HEATER USCITA/OUTPUT 0..20mA ALIM/POWER SUPPLY 24Vdc
- Code DNA508 : CON RISCALDAMENTO WITH HEATER USCITA/OUTPUT 0..5Vdc ALIM/POWER SUPPLY 12Vdc

157

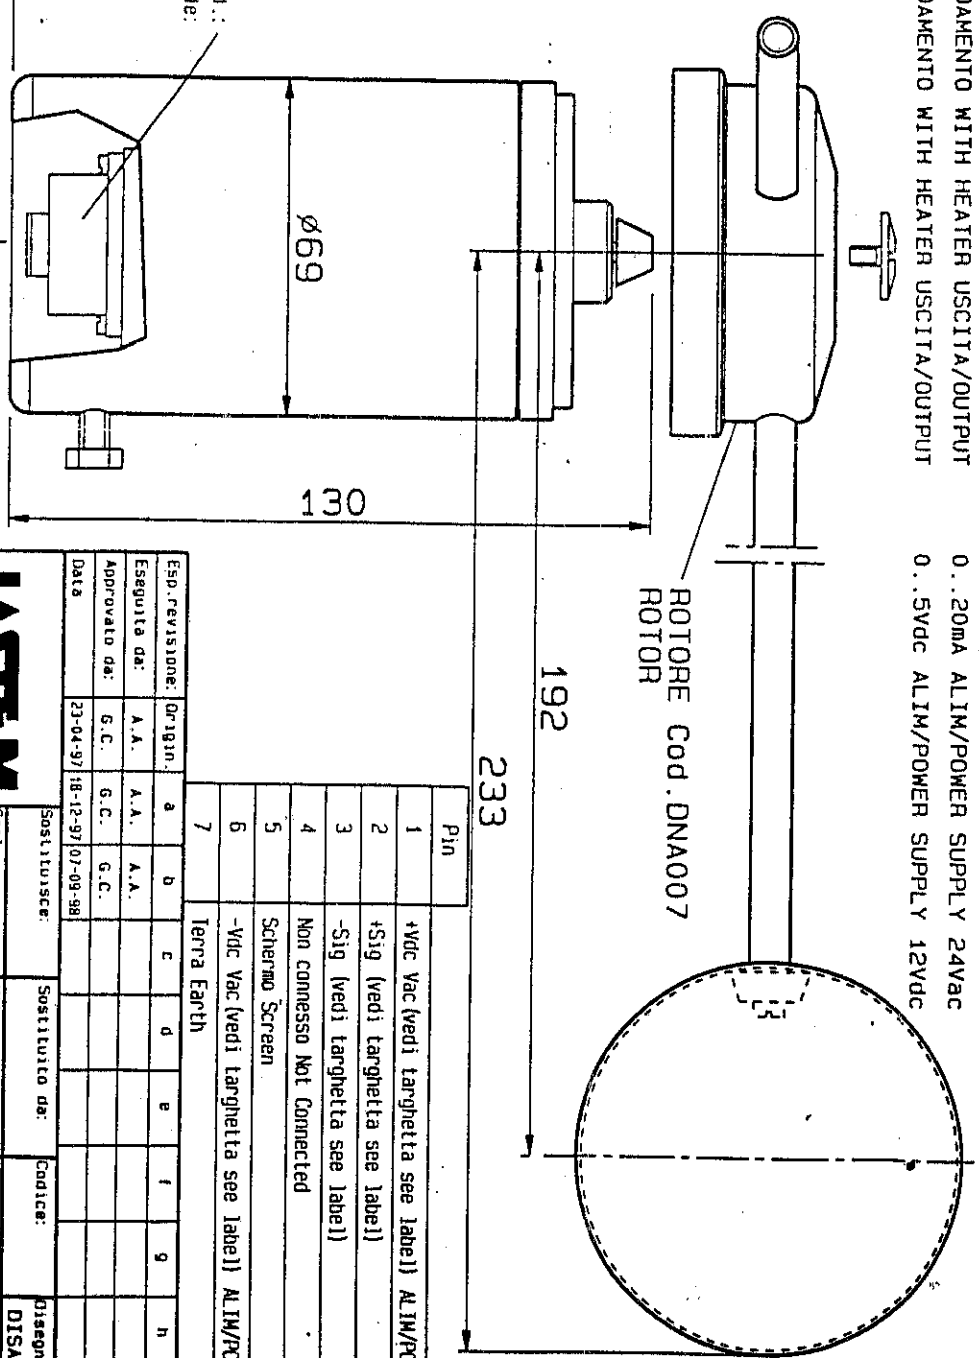

CONNETTORE PER CONNESSIONE CAVI Cod.:
 CONNETTOR FOR CABLES CONNECTION CODE:
 DNA510-DNA525-DNA526-DNA527

ATTACCO PER TUBI DA Ø48.5 A Ø50mm
 COUPLING FOR PIPE FROM Ø48.5 TO Ø50mm

Esp. revisione:	Origine:	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Eseguita da:	A.A.	A.A.	A.A.							
Approvato da:	G.C.	G.C.	G.C.							
Data	23-04-97	18-12-97	07-09-98							

Pin	Descrizione
1	+Vdc Vac (vedi targhetta see label) ALIM/POWER
2	+Sig (vedi targhetta see label)
3	-Sig (vedi targhetta see label)
4	Non connesso Not Connected
5	Schermo Screen
6	-Vdc Vac (vedi targhetta see label) ALIM/POWER
7	Terra Earth

LASTEM
 MILANO Italy

Descrizione: DOCUMENTO ACCOMPAGNATORIO TACONEMOMETRI AD USCITA NORMALIZZATA
 NORMALIZED OUTPUT TACONEMOMETER ATTENDANTI SHEET

Scale: Mat.: Tratt.: Coll.:
 Sostituito da: Codice: Disegno: DISACC3219
 Sostituisce: